

Datos técnicos


## Conjunto de cables Fluke 3PHVL-1730, cable de prueba de voltaje



### Descripción general del producto: Conjunto de cables Fluke 3PHVL-1730, cable de prueba de voltaje

Cable de conexión de voltaje plano trifásico para el Registrador de energía Fluke 1730.

## Modelos

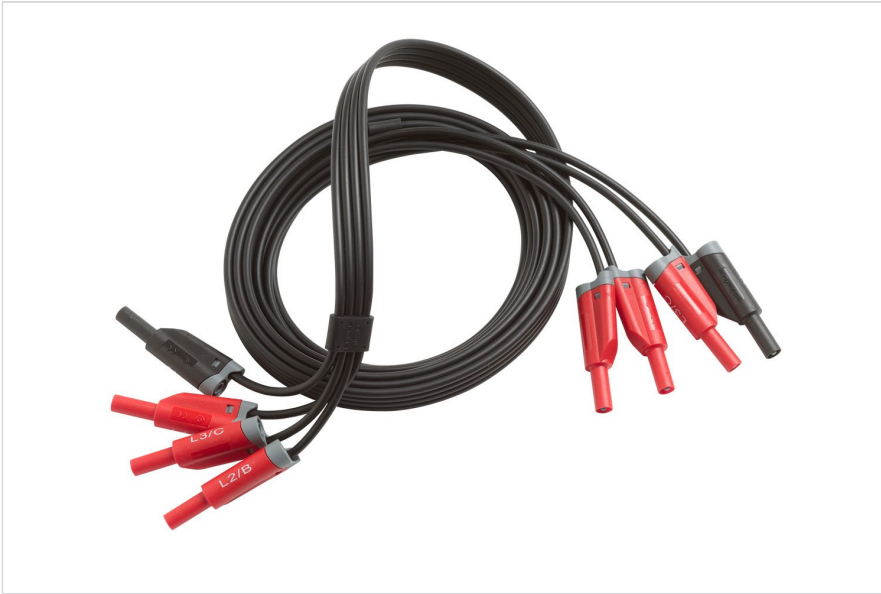

### **Fluke 3PHVL-1730**

Cable Assembly, Voltage Test Lead 3-Phase+N

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**

**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-cl](http://www.fluke.com/es-cl)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.

04/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**